

## 照射人全血液-LR「日赤」添付文書の図の誤りのお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本赤十字社の血液事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、照射人全血液-LR「日赤」の添付文書の図に誤りがあることが判明しましたので、訂正内容をお知らせいたします。

医療関係者の皆様には、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、今後は再発防止に努めてまいります。

今後ともご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。



謹白

### 1. 対象製剤

販売名	一般名	略号	包装
照射人全血液-LR「日赤」	人全血液	lr-WB-LR	血液 200mL に由来する血液量 1 袋 血液 400mL に由来する血液量 1 袋

### 2. 訂正内容

【組成・性状】 図 本剤（400mL 採血由来）の上清カリウム濃度  
（誤）

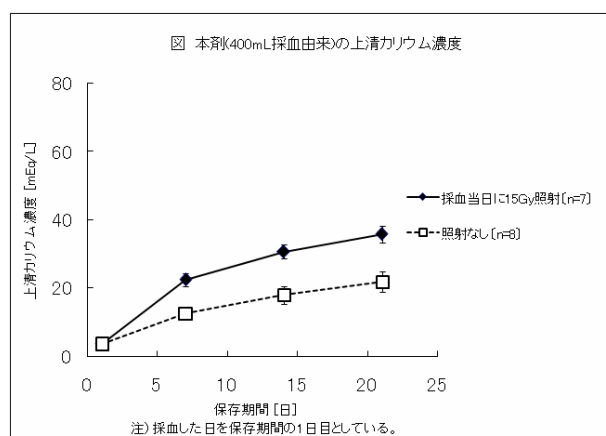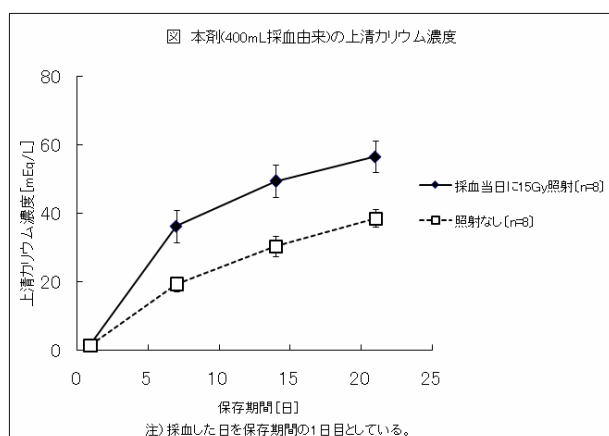

### 3. お問い合わせ

最寄りの赤十字血液センター医薬情報担当者へお願いいたします。